


インバータ方式
コードレス回診用X線装置

MU125M

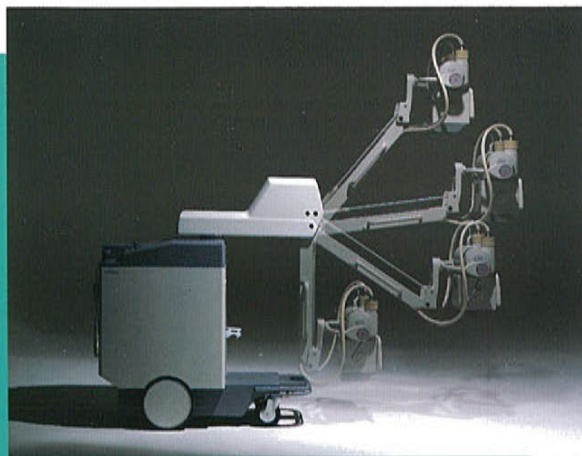

特 長


- 1 **30kHz高性能インバータ化**
被ばく線量の低減
- 2 **32kW大出力撮影**
高画質・短時間撮影
- 3 **小焦点・大電流撮影**
高速回転陽極・0.8mm焦点・400mA
- 4 **2ハンドル・2モータ駆動**
優れたハンドリング
- 5 **アーム完全バランス方式**
スピーディなポジショニング
- 6 **コードレス方式**
簡便な操作性

構 成

- (1) インバータ式高電圧装置
- (2) X線管装置 CIRCLEX 0.8U361C-35S
- (3) 可動絞リ
- (4) 本体台車装置

主な仕様

- 定 格 32kW (25kW 0.1sec時)
- 管 電 圧 40~125kV 1kVステップ
- mAs設定 0.5~125mAs 25%ステップ
- 管 電 流 160~400mA
- 電 源 自動車用バッテリー12V (35Ah/20時間率) 4個
- 移動速度 X線管装置が走行位置にあるとき
前進約4 km/h, 約2 km/h
後進約2 km/h
X線管装置が走行位置以外にあるとき
前後進とも約2 km/h
登はん力
最大7度
- X線管装置 X線管焦点サイズ : 0.8mm×0.8mm
陽極最大熱容量 : 99.4kJ (140kHU)
- カセット収納枚数
半切カセット 10枚

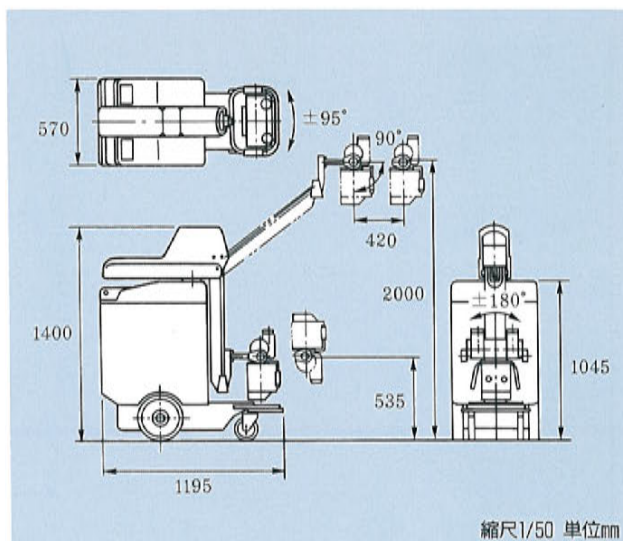

※外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※記載中の各数値は標準値を示しますので、実数値は若干異なることがあります。

承認番号 MU125M(04B)第0233号, サークレックス0.8U361C-35S(62B)第2021号

⊕ 島津製作所

医用機器事業部 604 京都市中京区西ノ京桑原町1 (075)823-1271